



RAC- Verstärker

nach Lukas & Dr. Ludger
Stenneken

Implantat- Nadelhalter

-Serie 2-

Einführung:

RAC-Verstärker sind Hilfsmittel, um den **Reflexe Auriculo-Cardiaque** bei aktiven Punkten der Ohrakupunktur nach Nogier und Bahr deutlicher werden zu lassen.

Dies erfolgt konstruktionsbedingt durch eine verbesserte Fokussierung der Informationen auf einen Punkt und / oder durch Ausschalten des Einflusses eventuell aktiver Punkte des Behandlers¹.

Sicherheitshinweise:

Alle RAC-Verstärker sind aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, welcher keine nennenswerte Eigenschwingung hat, die das Messergebnis verfälschen könnte. Dieser thermoplastische Kunststoff ist allerdings durch diese Eigenschaft empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Die RAC-Verstärker dürfen daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Sie werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und weisen daher sichtbare Schichten / Streifen auf.


Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkohobasis.

Sie sind nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar. Bei Verwendung der RAC-Verstärker ist kein direkter Hautkontakt zum Patienten vorgesehen. Die RAC-Verstärker sind von Kindern fernzuhalten und nur von in der RAC-kontrollierten

Ohrakupunktur ausgebildeten Therapeuten am Patienten anzuwenden.

Alle RAC-Verstärker der Serien 1 und 2 werden in Kombination mit Spitzampullen vom Durchmesser 9mm verwendet (Bezugsquelle z.B. Blum Akupunkturbedarf). Der Implantatnadelhalter wird mit den resorbierbaren Templax Implantatnadeln der Firma Lametec verwendet und kann entweder eine oder gleichzeitig zwei Ampullen des Durchmessers 9mm tragen.

Da es sich bei allen Ampullen um Glasampullen handelt, ist besondere Vorsicht bei der Handhabung geboten,

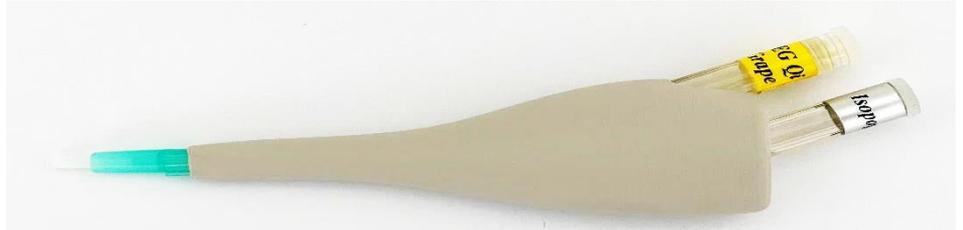

um Glasbruch und damit Verletzungen zu vermeiden.

Der Therapeut trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für eventuelle Verletzungen durch falsche oder missbräuchliche Anwendung der RAC-Verstärker. Ebenso trägt er auch bei Verwendung unserer RAC-Verstärker jederzeit die volle Verantwortung für die Behandlung der Patienten.

Da der Halter zum Setzen von resorbierbaren Implantatnadeln verwendet wird, sind alle Richtlinien und Anweisungen für das Setzen von Implantatnadeln zu beachten! Für das Setzen von Implantatnadeln ist eine besondere Ausbildung und ein Zertifikat der Firma Lametec Voraussetzung.

Defekte RAC-Verstärker dürfen nicht weiter verwendet werden. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Benutzungshinweise:

Wir haben den Implantatnadelhalter dafür konstruiert, um die Informationen von ein oder zwei Testampullen über innenliegende Lichtleiter gleichzeitig auf die Spitze einer resorbierbaren Templax Implantatnadel der Firma Lametec zu fokussieren und gleichzeitig den Einfluss des Behandlers auf die Messung zu minimieren bzw. auszuschalten.

Diese Konstruktion ermöglicht es z.B. eine Störherdampulle aus dem Störherd-Set und gleichzeitig ein Vitamin zu tragen. Es sind viele weitere Anwendungen denkbar, z.B. nur die ZNS-Gedächtnisblüte Clematis oder zusätzlich eine weitere Ampulle zur

Spezifizierung eines Punktes. Alle Punkte, die Resonanz auf mehrere Blüten haben, können durch den Einsatz zweier Blüten gleichzeitig mit einem deutlicheren RAC sicherer identifiziert und genauer gestochen werden. Der Behandler berührt bei der Messung und Nadelung die Ampullen nicht, so dass sein Einfluss ausgeschlossen wird.

In die beiden Slots des Implantatnadelhalters kann jeweils eine 9mm-Spitzampulle eingesetzt werden. Eine leichte Drehung fixiert die Ampullen. Zur Entnahme werden sie wieder leicht gedreht.

Die Implantatnadel wird aus ihrer Verpackung entnommen, und mit der Rückseite des Griffs in die Spitze des Implantatnadelhalters eingesetzt. Es ist auf festen Sitz zu achten und darauf, dass die sterile Spitze nicht berührt wird.

Der Halter ist an der Spitze so konstruiert, dass der Therapeut bei der Nadelung die Implantatnadel selbst in einer Mudra-Haltung (Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger) halten kann. Unter Tasten des RAC wird der Punkt durch berührungsfreie Annäherung der Nadelspitze am desinfizierten Ohr aufgesucht. Wenn der Punkt sicher bestimmt wurde, wird die Nadelspitze senkrecht auf die Haut aufgesetzt und die Nadelung wird durch kontrollierten Druck auf die Nadel durchgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren RAC-Verstärkern!

¹ Diese Anleitung gilt geschlechtsübergreifend, obwohl nur die männliche Form verwendet wird.