



RAC- Verstärker

nach Lukas & Dr. Ludger
Stenneken

Flaschenhalter

Klein (für 7,5ml
Oregon Grape)

-Serie 1-

Einführung:

RAC-Verstärker sind Hilfsmittel, um den **Reflexe Auriculo-Cardiaque** bei aktiven Punkten der Ohrakupunktur nach Nogier und Bahr deutlicher werden zu lassen.

Dies erfolgt konstruktionsbedingt durch eine verbesserte Fokussierung der Informationen auf einen Punkt und / oder durch Ausschalten des Einflusses eventuell aktiver Punkte des Behandlers¹.

Sicherheitshinweise:

Alle RAC-Verstärker sind aus dem gleichen Kunststoff hergestellt worden, welcher keine nennenswerte Eigenschwingung hat, die das Messergebnis verfälschen könnte. Dieser thermoplastische Kunststoff ist allerdings durch diese Eigenschaft empfindlich gegen Verbiegen, Herunterfallen und gegen Temperaturveränderungen. Die RAC-Verstärker dürfen daher nicht in der Sonne, in der Nähe von künstlichen Wärmequellen oder im Kühlschrank gelagert werden. Sie werden im 3D-Druckverfahren hergestellt und weisen daher sichtbare Schichten / Streifen auf.

Das Material ist nebelfeucht desinfizierbar mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis. Sie sind nicht thermisch desinfizier- oder sterilisierbar. Bei Verwendung der Geräte aus Serie 1 ist kein direkter Hautkontakt zum Patienten vorgesehen. Die RAC-Verstärker sind von Kindern fernzuhalten und nur von in der RAC-kontrollierten Ohrakupunktur ausgebildeten Therapeuten am Patienten anzuwenden.

Alle RAC-Verstärker der Serie 1 bis auf die Flaschenhalter werden in Kombination mit Spitzampullen vom Durchmesser 9mm verwendet. Die Flaschenhalter gibt es in zwei Größen für Blütenflaschen 15ml und 7,5ml. Der Ampullenhalter Kompakt und der V-Halter sind ausschließlich für 9mm Spitzampullen konstruiert. Unser Implantatnadelhalter wird mit den resorbierbaren Templax Implantatnadeln der Firma Lametec verwendet und kann gleichzeitig zwei Ampullen des Durchmessers 9mm oder 8mm (z.B. mit homöopathischen Mitteln) tragen. Da es sich bei allen Ampullen um Glasampullen handelt, ist besondere Vorsicht bei der Handhabung geboten, um Glasbruch und damit Verletzungen zu vermeiden.

Der Therapeut trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für eventuelle Verletzungen durch falsche oder missbräuchliche Anwendung der RAC-Verstärker. Ebenso trägt er auch bei Verwendung unserer RAC-Verstärker die volle Verantwortung für die Behandlung der Patienten.

Defekte RAC-Verstärker dürfen nicht weiter verwendet werden. Die Entsorgung erfolgt über den normalen Hausmüll.

Benutzungshinweise:

Wir haben die beiden Flaschenhalter dafür konstruiert, um den Einfluss der Blüten des negativen und destruktiven Qi auf den Behandler während der Messung zu minimieren bzw. auszuschalten.

Der kleinere Flaschenhalter ist für die 7,5ml Flasche Oregon Grape und der größere Flaschenhalter für die 15ml Flasche Blue China Orchid konstruiert worden (Blütenflaschen sind bei der Firma Blum separat erhältlich).

So kann der Behandler die Flaschen mit den Blüten des negativen bzw. destruktiven Qi zur Messung in die Nähe des Patienten bringen, ohne selbst die Blütenflaschen direkt berühren zu müssen. Dies verhindert eine eventuelle Oszillation oder Schwächung des Behandlers, welche die Messung am Patienten unmöglich machen oder erschweren würde.


Zuerst wird Verpackungsmaterial von den Blütenflaschen entfernt. Dann wird die Flasche mit der Pipettenseite zuerst in die Aussparung am Griff eingeschoben (1). Wenn der Deckel der Flasche im Flaschenhalter anstößt, wird die Flasche kippend eingeklickt (2) siehe Abbildung. Die Entnahme erfolgt umgekehrt, d.h. zuerst an der Spitze nach oben herausklicken und dann nach unten entnehmen. Sollte der Flaschenhalter

nicht sofort vollständig einzuklicken sein, ist der Verschlussdeckel der Blütenflasche um etwa eine halbe Umdrehung zu lösen und nach dem Einklicken wieder festzudrehen.

Zu häufiges Einsetzen und Entnehmen der Blütenflasche in bzw. aus dem Flaschenhalter kann den Flaschenhalter oder die Verschlusskappe der Blütenflasche beschädigen. Es ist aber auch nicht erforderlich, die Blütenflasche wieder aus dem Halter zu entfernen, da die Blüten des negativen und destruktiven Qi nicht therapeutisch gegeben werden und die Testung am besten mit vollen Flaschen erfolgt.

Der Halter wird zur Messung am Griff gehalten, ohne die Flasche zu berühren. Dann wird die Ampulle mit der Testsubstanz im Halter über den zu untersuchenden Bereich am Körper des Patienten (z.B. zwischen LG16 und LG20 oder über die Punkte EN-4 und EN-5 am Mittelfinger der dominanten Hand) geführt. Dabei wird der RAC getestet, um den oder die aktiven Punkte zu finden.

Abbildung

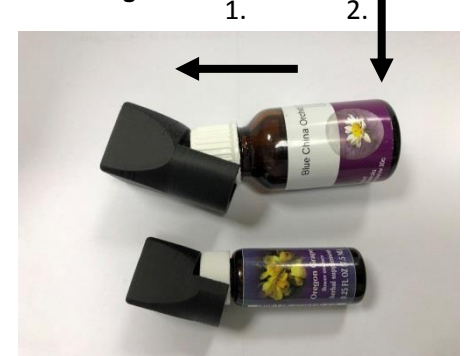

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren RAC-Verstärkern!

Diese Anleitung gilt geschlechtsübergreifend, obwohl nur die männliche Form verwendet wird.¹

Vertrieb:

Akupunkturbedarf Karl Blum GmbH
Breslauer Straße 42
D - 82194 Gröbenzell
Tel.: 0 81 42 / 44 84 80
Fax: 0 81 42 / 44 84 820
Internet: www.Blum-Akupunktur.de
Mail: info@blum-akupunktur.de